CMA
221712050059

武汉净澜检测有限公司

监测报告

武净（监）字 2022 1599

项目名称：华新水泥（武穴）有限公司CEMS系统比对监测

监测类别：委托监测

委托单位：华新水泥（武穴）有限公司

报告日期：2022 年 6 月 24 日

（加盖检测专用章）

1. 报

2. 报

3. 对

本公司提出

4. 若

果负责，

5. 未

的报告复印

6. 除

期的样品均

7. 本

武

争（监）字 202 21599

新

前言


受华新水泥（武穴）有限公司委托，武汉
水泥（武穴）有限公司 K2 窑尾废气排气筒
华新水泥（武穴）有限公司 K2 窑尾废气
科技股份有限公司制造并安装，CEMS 是
EMS、烟气参数测量子系统、数据采集与
司 K2 窑尾废气排气筒的 SCS900D 型 CE

依据

3/T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物
75-2017《固定污染源烟气（SO_2、NO_x、颗
76-2017《固定污染源烟气（SO_2、NO_x、颗
法》；
《空气和废气监测分析方法》（第四版）。

22 年 6 月 16 日对华
监测。
放监测系统由北京雪
该系统由气态污染
华新水泥（武穴）有
道上。

方法》；
技术规范》；
统技术要求及检测

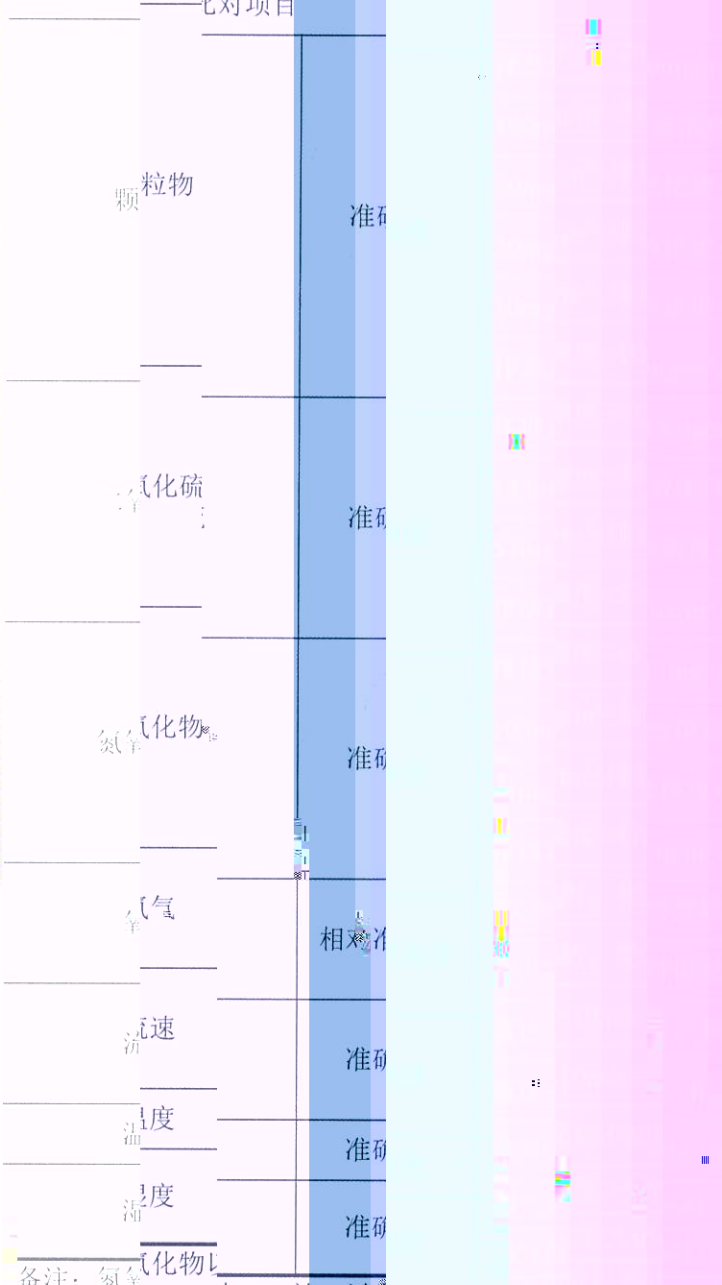

化对项目

颗粒物

准确

氧化硫

准确

氮氧化物

准确

氧气

相关准

流速

准确

温度

准确

湿度

准确

氮氧化物以

备注：氮氧化物以 NO_2 计，以工


四、工况

监测期间该厂生产正常

武净（监）字 2

20221599

三、标准

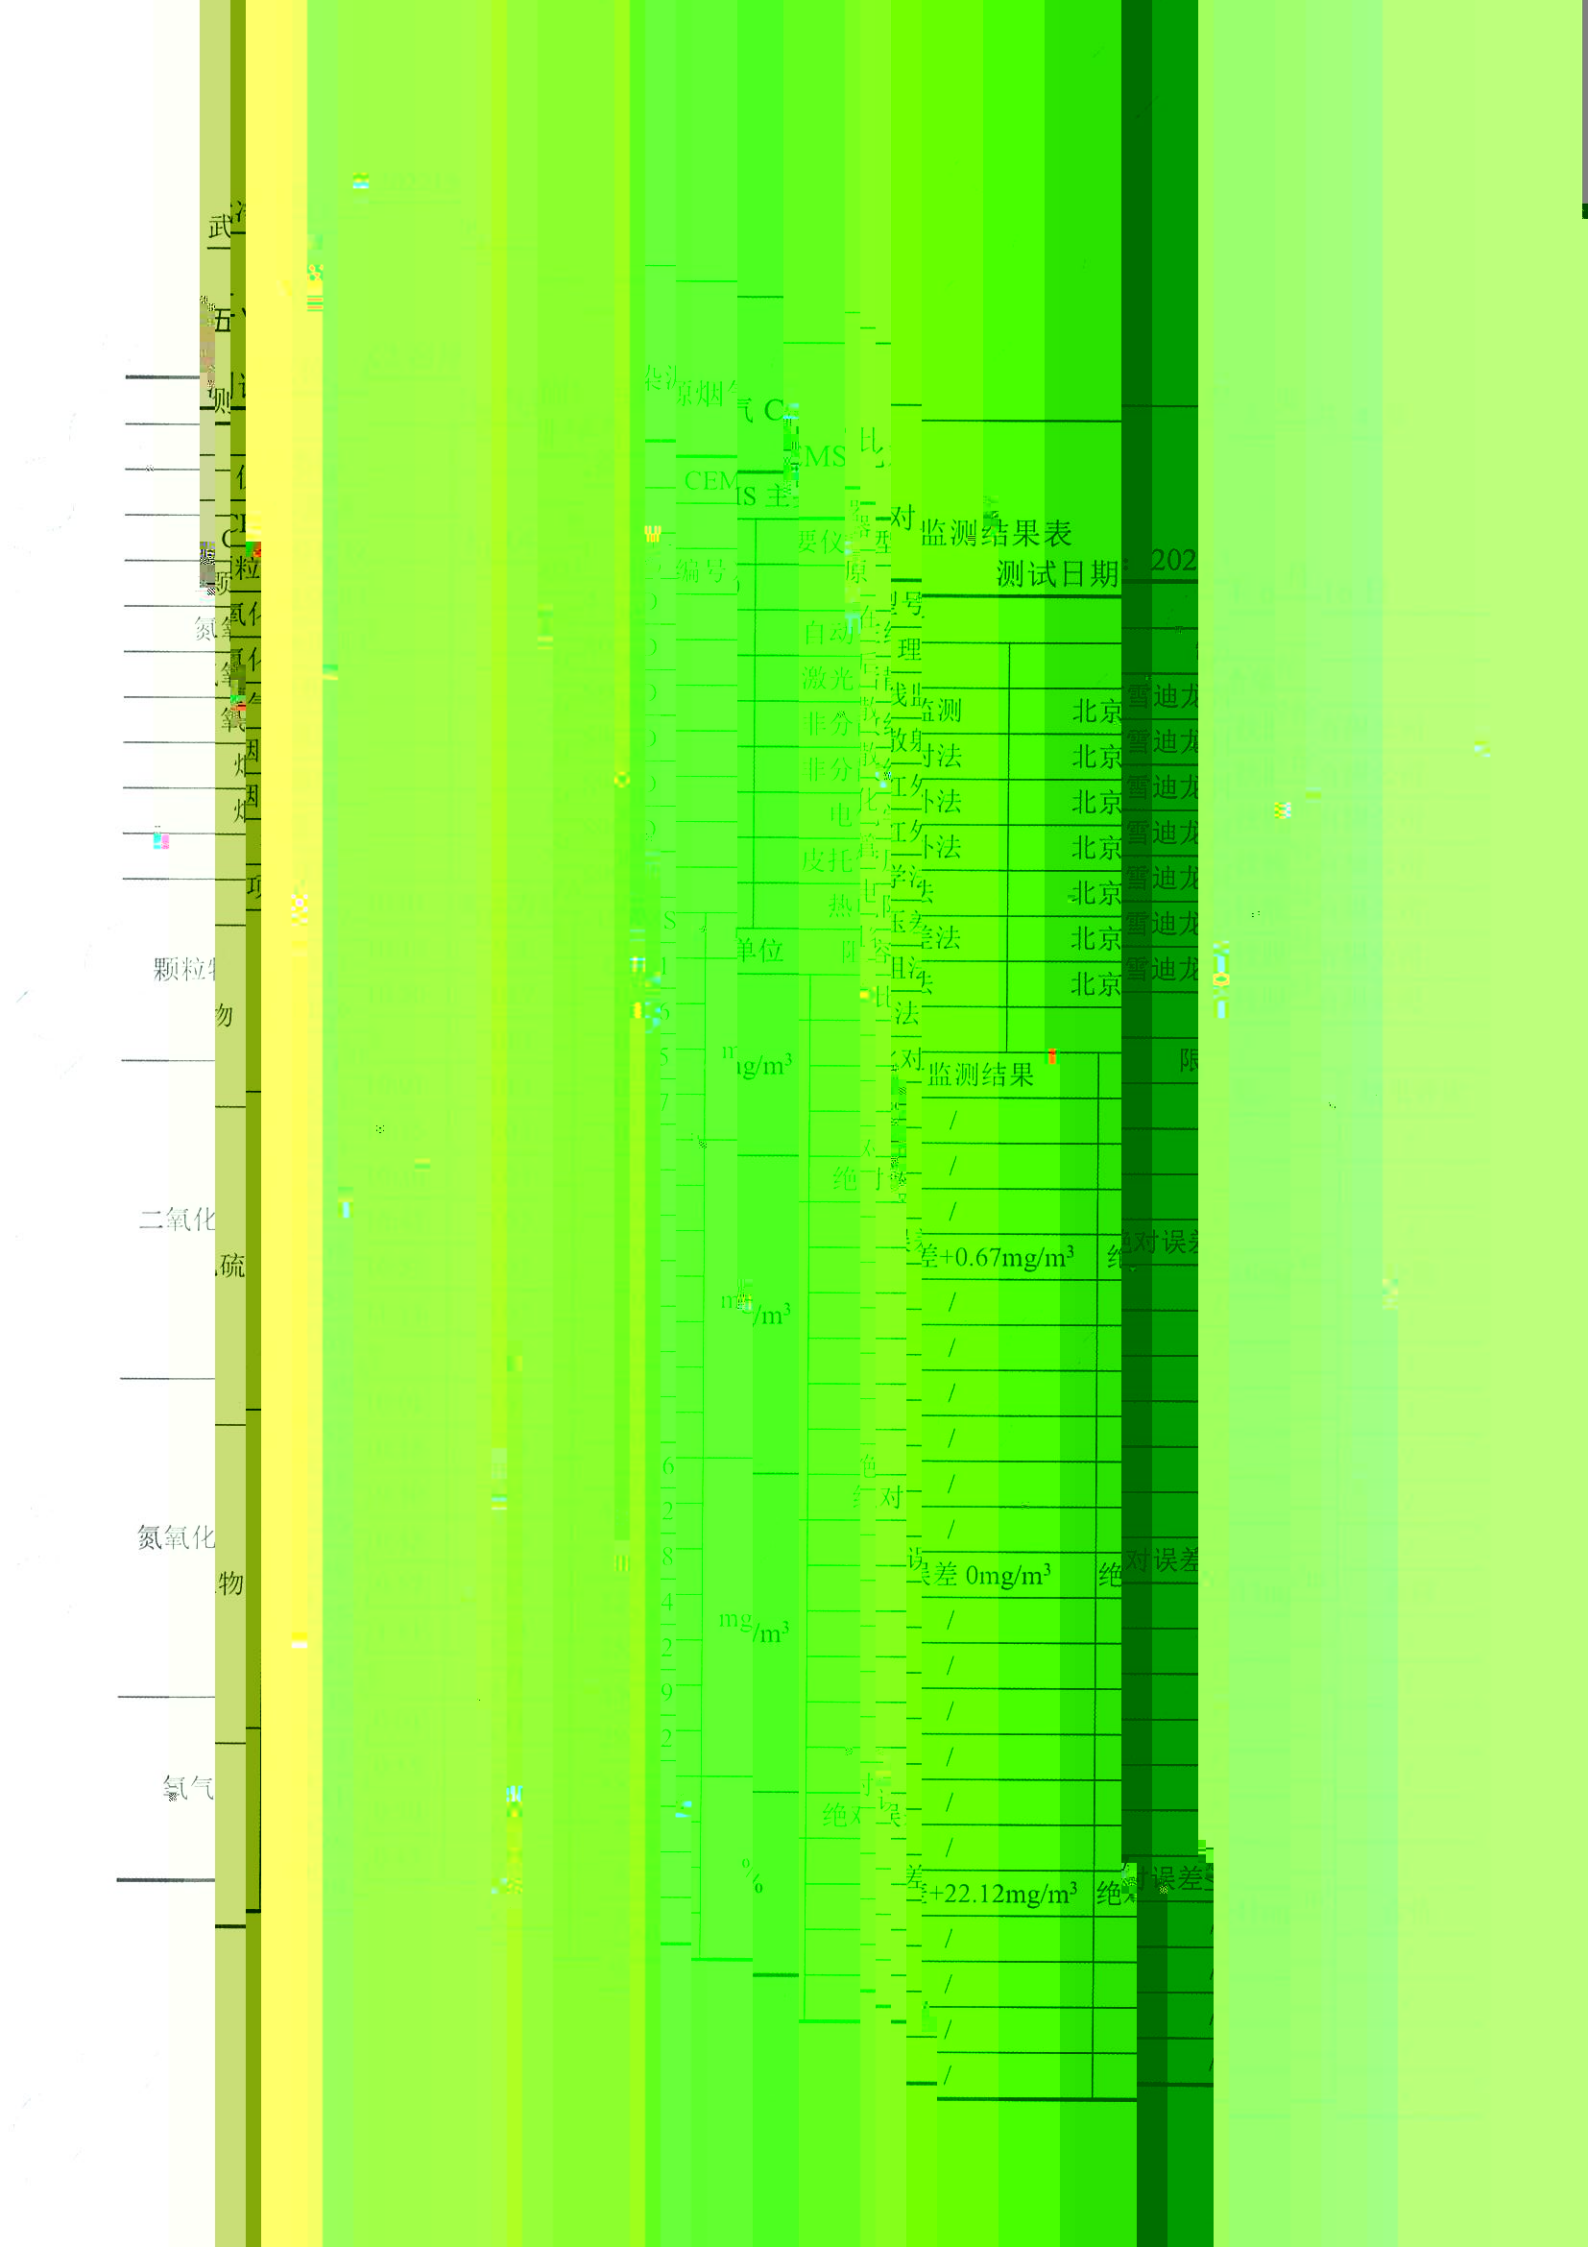
监测结果表
测试日期
202
北京
雪迪龙
监测结果
/
差+0.67mg/m³
差 0mg/m³
差+22.12mg/m³
绝对误差
颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
氧气
mg/m³
%

武净（监）字2[illegible]21590

项目		参比方法
烟气流速	09:53~10:07	7.2
	10:11~10:25	7.4
	均值	7.0
	09:57~10:11	6.4
	10:11~10:25	6.7
	10:26~10:40	6.5
	均值	6.5
烟气温度	09:57~10:11	119
	10:11~10:25	123
	10:26~10:40	115
	均值	118
湿度	09:57~10:11	10.5
	10:11~10:25	10.7
	10:26~10:40	10.6
	均值	10.6

所用标准气体	名称	编号	浓度	有效期
二氧化硫	L210[illegible]4135	[illegible]0.
氮氧化物	20[illegible]172	29[illegible]
氧量	L130[illegible]3145	[illegible]
一氧化碳	L2011[illegible]9044	30[illegible]

参比方法	所用仪器名称
烟气流速	智能大流量低浓度烟尘测试仪
烟气温度	
烟气湿度	
二氧化硫	
氮氧化物	
颗粒物	

结论：[illegible]颗粒物、温度、流速、湿度、烟气（SO2、NOx）排放浓度[illegible]染源烟气[illegible]，结果以[illegible]

备注：“(0)”表示未检[illegible]

编制 [illegible]

日期 [illegible]2022.06.[illegible]