221712050059

武汉净洲检测

监测报

武净（监）字20

项目名称：华新水泥（CEMS系

监测类别：委

委托单位：华新水泥（

报告日期：2022年

（加盖检测专用章）

1.

2.

3.

提出，

4.

不对样

5.

复印件

6.

品均不

7.

武净（监）字 202[illegible]2475

三、评价标准

比对项目		考核
颗粒物	准确度	相对误
二氧化硫	准确度	相对
氮氧化物	准确度	相对
氧气	相对准确度	±1.0%
流速	准确度	不超过
温度	准确度	误差不
湿度	准确度	误差不

备注：氮氧化物以 NO_2 计，以上各参数[illegible]

四、工况

监测期间该[illegible]生产正常，比对监[illegible]同一生

武汽 监

吉泉

五、

测试

名

颗粒

烟

烟

烟

9:

10:

11:

颗粒物

9:

10:

烟气流速

11:

9:

10:

烟气温度

11:

9:

10:

烟气湿度

11:

参比方法

颗粒物

烟气流速

烟气温度

烟气湿度

结论

22 年 3 月 3 日

制造单位

迪龙

迪龙

迪龙

迪龙

迪龙

置

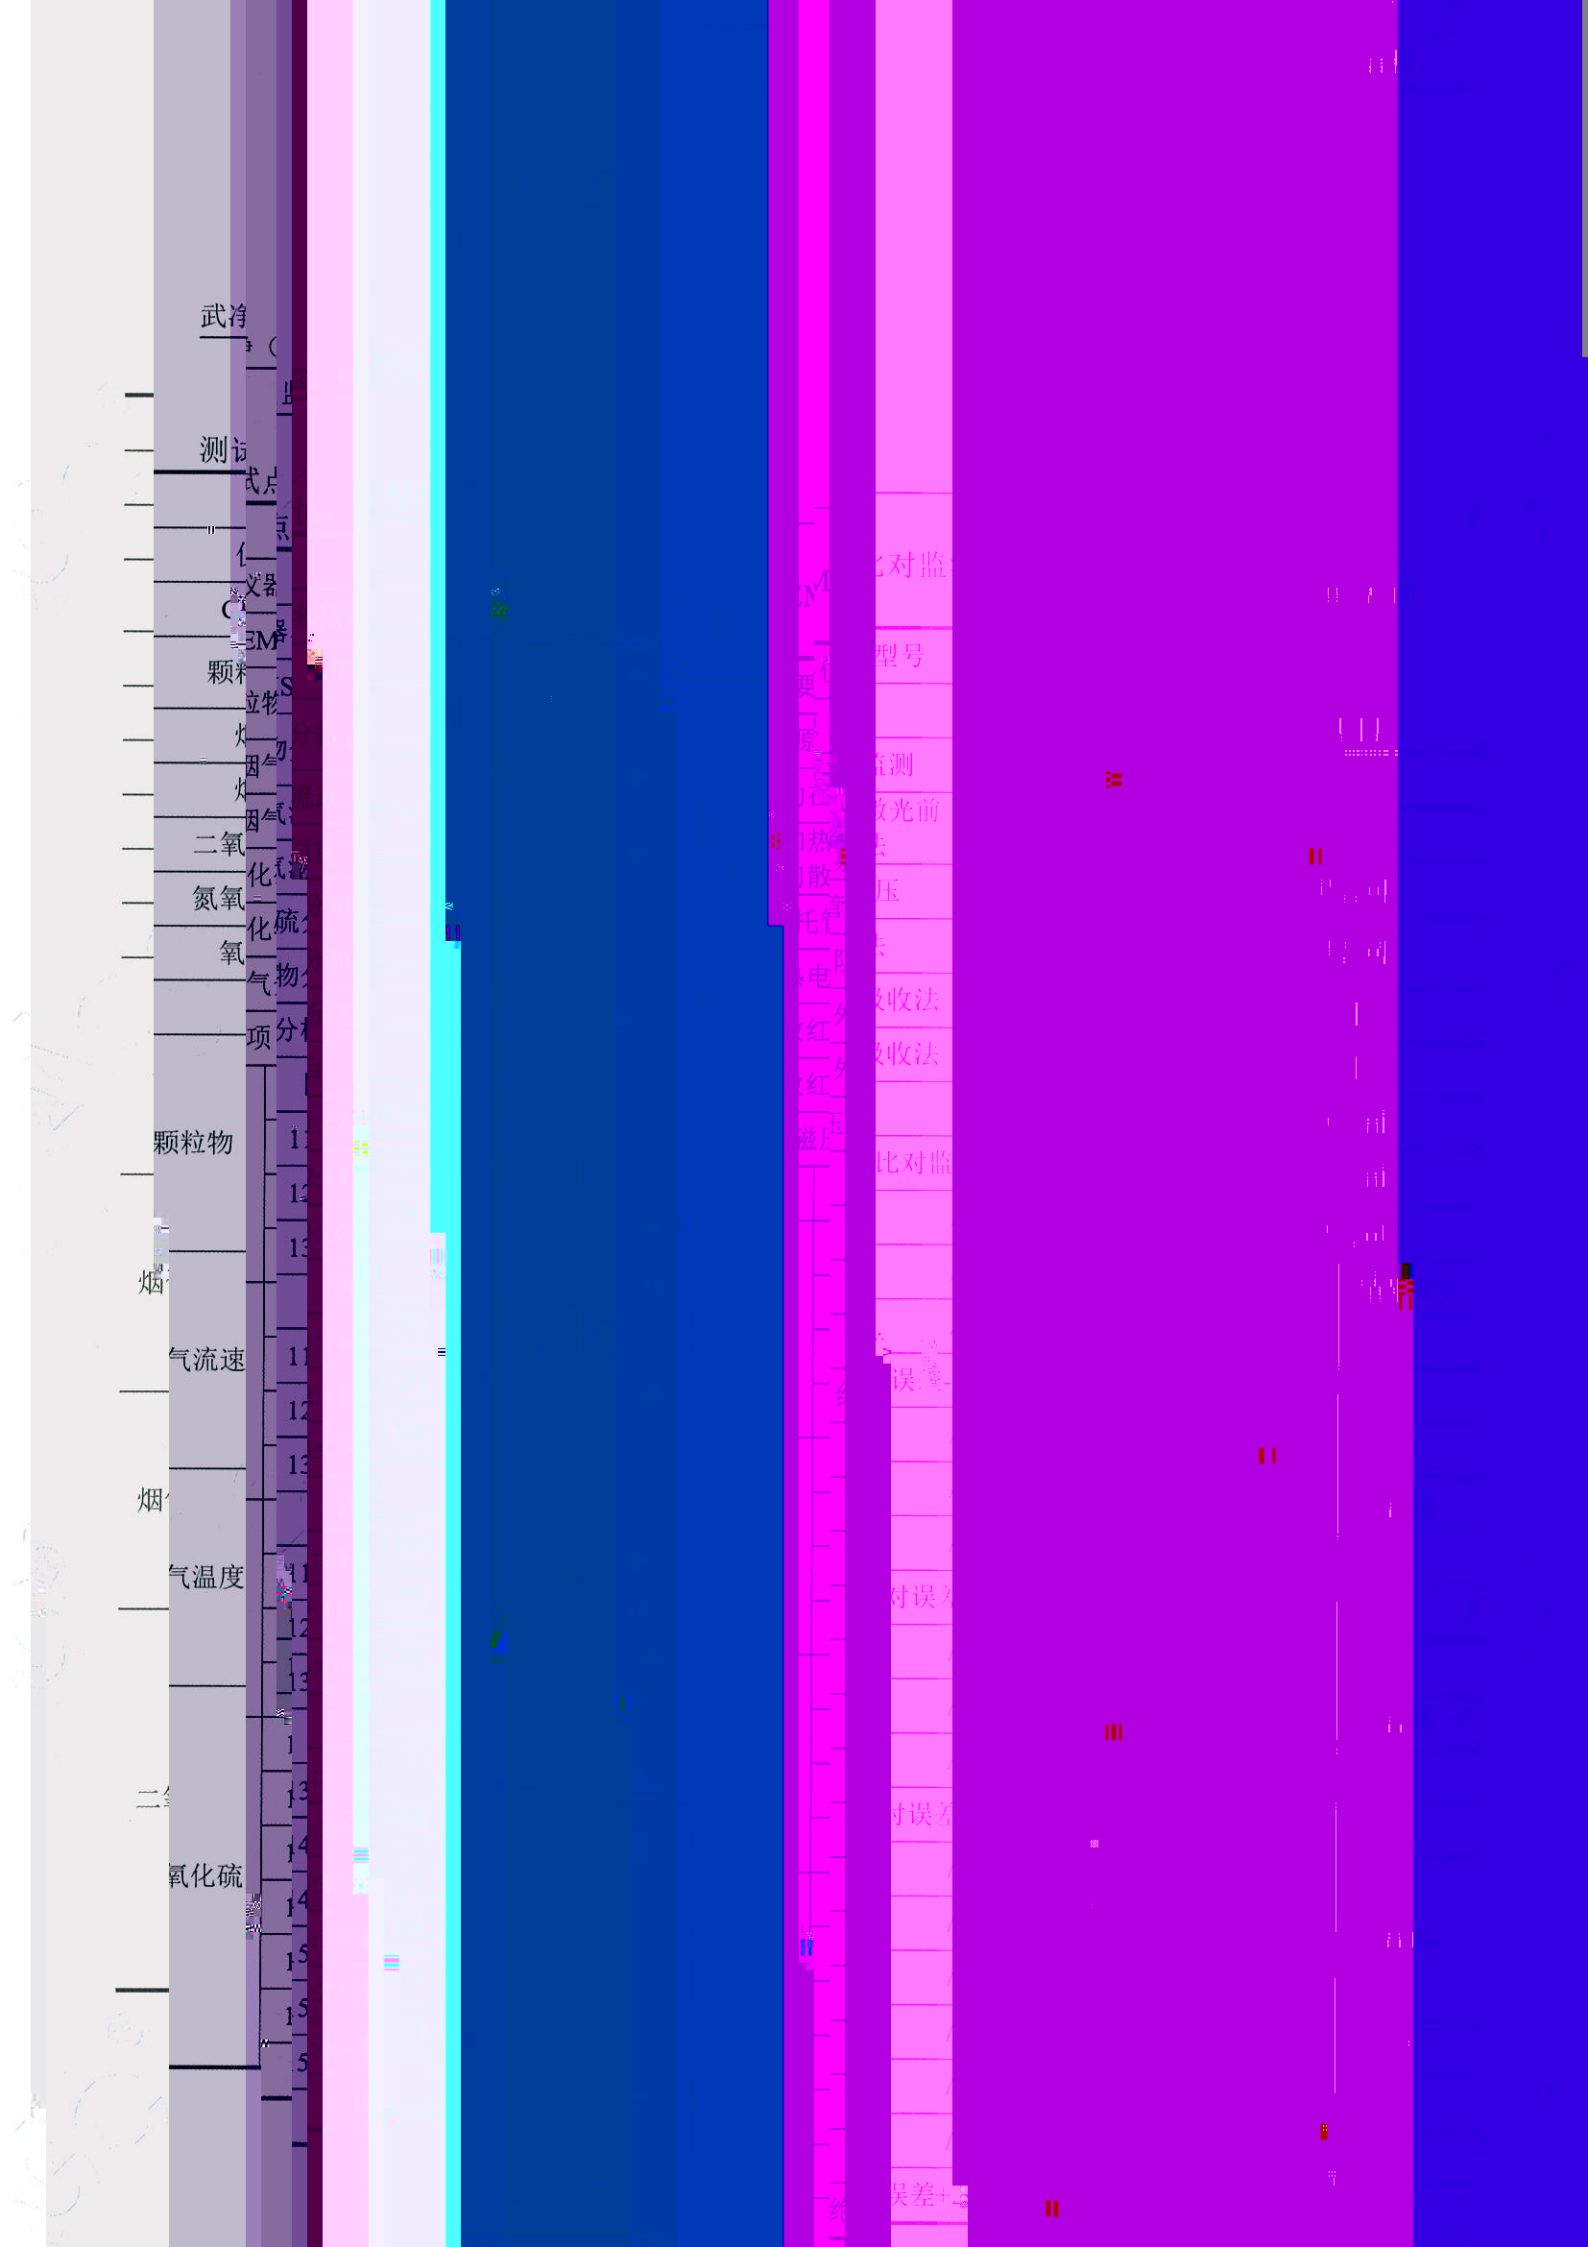
限

结果评定

/

/

/


武
测
颗
二氧
氮氧
氧
项
颗粒物
烟
气流速
烟
气温度
二
氧化硫
型号
测
光前
压
收法
收法
比对监
误
对误
对误
误差

武

氮氧化物	
氧气	
所用标准气体名称	
二氧化硫	
一氧化氮	
二氧化氮	
氧气	
一氧化碳	
参比方法	
颗粒物	
烟气流速	
烟气温度	
二氧化硫	
氮氧化物	
氧量	
结论	

果表

式日期:

2022

制造

雪

雪

雪

雪

雪

限

/

/

/

颗粒

m^3 绝对

误差≤

/

/

/

烟气流

相对误差

/

/

/

烟气流

绝对误差

/

/

/

烟气流

相

对误差

参比

原理

颗

重量法

烟气

皮托管法

烟气

热电偶法

烟气

干湿球法

结

HJ 75-201

7《固定

SO_2、

字 20

监

1 号

系统

流速

温度

湿度

~8:1

49

~8:5

7:25

~9:3

8:01

值

~8:1

49

~8:5

7:25

~9:3

8:01

值

~8:1

49

~8:5

7:25

~9:3

8:01

值

~8:1

49

~8:5

7:25

~9:3

8:01

值

烟

烟

烟

烟

烟

颗

N_x、颗

编制

日期

比对

测

MS

仪器

理

监测

在线

测

测

管

法

法

阻

度

比对

测

绝

差

0.59

果

相

误

差

-0.

mg/m³

统

对

误

差

-0.

%

相

对

误

差

-0.

编

220

-08

-00

300

1-0

3

Y-1

项

指

0%

度

求

束

原

重量法

皮托管

热电偶

干湿球

检

日

发

期